

DİKEY PROFİL PROJEKTÖRÜ

ÖZELLİKLER

- İŞ PARÇALARININ VE PROFİLLERİN KONTROLÜNDE KULLANILIR
- MÜKEMMEL KALİTEDE BÜYÜTME SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANMIŞTIR
- 0.08% İN ALTINDA SAPMA İLE KONTÜR ÖLÇÜMÜ
- KULLANIŞLI KOORDİNAT TRANSFER VE BİLGİ İŞLEME SİSTEMİ

STANDART AKSESUARLAR

- ANA GÖVDE 1 ADET
- LENS 1 ADET
- YARI YANSITICI PARÇA (LENS İLE) 1 ADET
- EKTRAN YAY FİKSTÜRÜ 4 ADET
- 2m GÜÇ KABLOSU 1 ADET
- KULLANMA KILAVUZU 1 ADET
- SERTİFİKA 1 ADET
- PAKET LİSTESİ 1 ADET
- 4A/5 x 20 SİGORTA 5 ADET
- 24V 150W HALOJEN LAMBA AMPUL 2 ADET



AS-641010

DETAYLAR

KOD	AS-641010 / AS-641011	AS-641020 / AS-641021
GÖRÜNTÜLEME YÖNÜ	DİREKT / İNDİREKT GÖRÜNTÜLEME	DİREKT / İNDİREKT GÖRÜNTÜLEME
AYDINLATMA	TAŞIMA VE YANSITMA IŞIK KAYNAĞI 24V/150W-HALOJEN LAMBA	TAŞIMA VE YANSITMA IŞIK KAYNAĞI 24V/150W-HALOJEN LAMBA
GÜÇ	110V/220V(AC), 50/60Hz, 400W TOPLAM GÜÇ	110V/220V(AC), 50/60Hz, 400W TOPLAM GÜÇ
İŞIK KAYNAĞI SOĞUTMASI	HAVA SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMA
ÖLÇÜLER (mm)	770 x 550 x 1100	770 x 550 x 1100
AĞIRLIK (kgs)	130	160
FİYAT USD	\$	\$

ÇALIŞMA TABLOSU

KOD	AS-641010 / AS-641011	AS-641020 / AS-641021
PROJEKSİYON ÖLÇÜSÜ (mm)	340 x 152	404 x 228
CAM TABLA ÖLÇÜSÜ (mm)	196 x 96	260 x 160
X EKSENİ KURS BOYU (mm)	150	200
Y EKSENİ KURS BOYU (mm)	50	100
Z EKSENİ KURS BOYU (mm)	90 (ODAKLAMA İÇİN)	90 (ODAKLAMA İÇİN)
ÖLÇÜM DOĞRULUĞU	4.0+L/25 µm L: ÖLÇME BOYU (mm)	4.0+L/25 µm L: ÖLÇME BOYU (mm)
ÇÖZÜNÜRLÜK (X/Y-axis)	0.001 mm (1µm) veya 0.0005 mm (0.5µm)	0.001 mm (1µm) veya 0.0005 mm (0.5µm)
FİYAT USD	\$	\$

PROJEKTÖR EKRANI

KOD	AS-641010 / AS-641011 / AS-641020 / AS-641021
ÖLÇÜLER	12" (Ø312 mm), KULLANILABİLİR KAPASİTE > Ø300 mm
DÖNDÜRME ARALIĞI	0°~360°
AÇI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	1' veya 0.01°
FİYAT USD	\$

OBJEKTİF LENSİ

BÜYÜTME	10X (STANDART)	20X (OPSİYONEL)	50X (OPSİYONEL)
OBJEKTİF GÖRÜNÜMÜ (mm)	Ø30	Ø15	Ø6
ÇALIŞMA MESAFESİ (mm)	77.7	44.3	38.4

OPSİYONEL

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT USD
AS-641050	DÖNDÜRÜLEBİLİR TABLA	\$
AS-641051	DÖNDÜRÜLEBİLİR MERKEZ DESTEK	\$
AS-641052	SINIR DEDEKTÖRÜ	\$

BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ

AÇIKLAMA
DC-3000 ÇOK FONKSİYONLU BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ : KOORDİNAT KAÇIRMA, mm/inç DÖNÜŞÜMÜ, 0 AYARLAMA 0°, 90°, 270°, 360° DÖNÜŞÜMLERİ, DOĞRUSAL KOMPANSATÖR

ASIMETO KALİBRASYON LABORATUARI

Tüm ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin kalite ve kalibrasyon doğruluğu ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında hassas incelemelerle yapılmaktadır.

İncelemeler sırasında tüm hassas ölçü aletlerinin ASIMETO tarafından oluşturulan dizayn ve Dünya çapında standartlarla belirlenen toleranslara uygunluğu %100 olarak kontrol edilir.



Yalnızca Dünya'nın önde gelen firmaları tarafından üretilen son teknoloji kalibrasyon ekipmanları kullanılarak ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin ölçüm hassasiyeti garanti altına alınır.

ASIMETO Kalibrasyon Laboratuvarındaki kalibrasyon ekipmanları hedef marketin ihtiyacına göre DIN, ASME, JJG gibi Uluslararası normların tamamına uyum gösterecek yazılımlarla donatılmıştır.

Tüm bu sayılanlara ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında çalışanların uzmanlık, özveri ve çalışkanlıkları da eklendiğinde ihtiyacınızı karşılayacak hassasiyetteki ölçü aletine ödediğiniz her kuruşun karşılığını tamı tamına alacak şekilde sahip olduğunuza emin olabilirsiniz.

ASIMETO

Calibration Lab

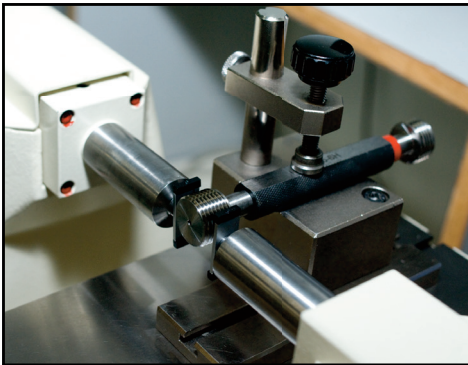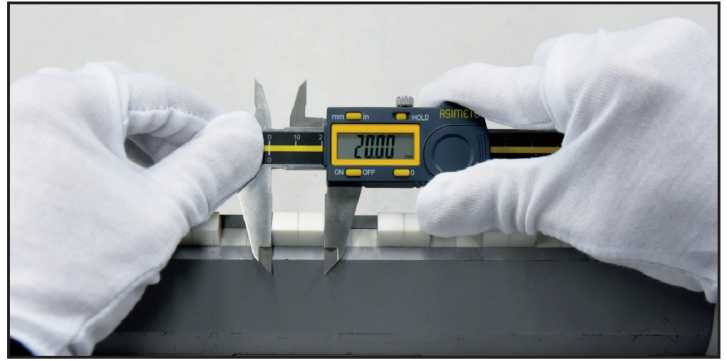

2 Ürün Açıklaması

Kalibrasyon Sertifikası

ASIMETO
Calibration Lab

Certificate No G30001
Part Number 307-06-0
Serial Number GS102042
Standard Name ASME B89.1.14
Tool 0-150mm/0-6"
Range 0.01mm/0.0005"
Resolution Digital Calipers

Function Inspection Passed Visual Inspection Passed

Outside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
1	0.0000	±0.001"	0.0000	
2	1.0000"	±0.001"	-0.0010	
3	3.0000"	±0.001"	-0.0010	
4	4.5000"	±0.001"	-0.0015	
5	6.0000"	±0.001"	-0.0015	

Inside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
6	0.2000"	±0.001"	0.0010	
7	1.0000"	±0.001"	0.0010	

Depth Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
8	0.0000	±0.001"	0.0000	

Master information

Depth set	258254	NIST-192837	Due Date
Gauge Block Set	258254	NIST-95837	2013-8-1
Setting Rings	258254	NIST-455837	2013-8-1

Uncertainty 6 µm +10⁻⁶×L Temperature 20 °C +/-0.5°C Humidity 50 % +/-15%

Attach invoice for proof of purchase date

* Check mark indicates within tolerance

Calibrator

Approved By

Asimeto (Guangzhou) Inc. Calibration Lab

402 Building B, Yushu Industrial Zone, Lufeng District, Guangzhou, China;

Tel: 020-82019119 Fax: 020-822261




1 Ölçüm Noktası
& Sonuç

3 Eğilim


4 Takip No.

Bilgi Çıkışlı Ölçü Aletleri

ABS Dijital Kumpas

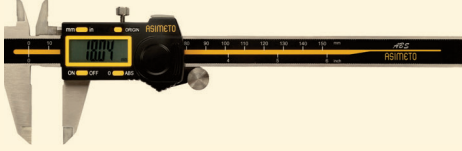

Derinlik Kumpası

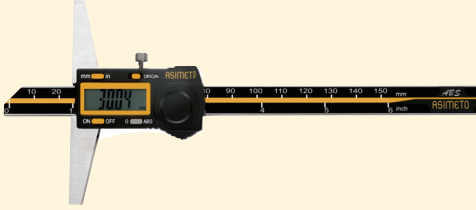

Dijital Mikrometre



Dijital Komparatör Saati



Sanal klavye verileri
toplar ve doğrudan
standart Microsoft
yazılımlarına iletir.
(Excel, Access)



Ölçüm Raporu

	A	B	C	D	E
1		A1	A2	A3	
2	1	10.02	15.53	20.44	
3	2	10.04	15.53	20.46	
4	3	10.01	15.52	20.44	
5	4	10.01	15.53	20.45	
6	5	10.02	15.54	20.46	
7					
8					
9	Average	10.02	15.53	20.45	

BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI 900 SERİSİ

	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	GİRİŞ TİPİ	FORMAT	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	KOD NO.
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	USB	Dot Data Format	307-XX-2 ; 307-XX-3 105-XX-4 ; 105-XX-5 315-XX-6 ; 315-XX-8	900-05-4
			Comma Data Format		900-05-5
	IP65 Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	407-XX-2 ; 407-XX-3 407-XX-4 ; 407-XX-5	900-07-0
			Comma Data Format		900-07-1
	Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	405-95-X ; 405-01-X 405-02-X ; 405-04-X	900-20-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-2
	Wireless Tip için Ayak Kontrol Butonu				900-90-1

KABLOSUZ BİLGİ ÇIKIŞ TİPLERİ 901 SERİSİ

	KULLANILDIĞI ÜRÜN TİPİ	FONKSİYON	FREKANS	KOD NO.
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter	2.4G	901-00-2
	IP65 Dijital Komparatör Saati ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Receiver	2.4G	901-00-3
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter	2.4G	901-00-4
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-6
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-7

